




ANEXO B



Formato para la presentación de la Propuesta Técnica.

DIRIGIDO A: GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS GET-OMG-INV-182/2022
REFERENTE A VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE,
PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA

Table with 8 columns: PARTIDA, CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, PROPUESTA TÉCNICA DETALLADA, MARCA, CLAVE O MODELO, TIEMPO DE ENTREGA, TIEMPO DE GARANTIA. Row 1: 1, 1, PZA, (DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1): AMBULANCIA DE URGENCIAS BÁSICAS EN VAN 11.5 M3 DUCATO DIESEL AÑO 2022 TRANSMISION MANUAL. FICHA TÉCNICA: • 11.5 MANUAL 2022 CILINDRADA (CM3) / NÚMERO Y DISPOSICIÓN 2,287 CM3 / 4 EN LÍNEA... CARROCERÍA CONCEPTO ELABORACIÓN DE ESTRUCTURA TUBULAR... CABINA DE PACIENTES. MARCA: FIAT, CLAVE O MODELO: 2022, TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO, TIEMPO DE GARANTIA: 24 MESES EN VEHICULO Y 12 MESES EN CONVERSION.


Matriz: Blvd. Atlixcáyotl No. 4000 A Teléfono: 222 168 0808 Colonia Emiliano Zapata 72824 San Andrés Cholula, Puebla.



		<p><b>CONCEPTO</b>  MAMPARA DIVISORIA ENTRE LA CABINA DEL CONDUCTOR Y LA CABINA DE PACIENTES, FABRICADA EN FABRICADA EN PERFIL DE 1X1 CAL.16 CON ACABADO EXTERIOR DE FIBRA DE VIDRIO DE 3MM, COLOR BLANCO TOTALMENTE LISO, CON VENTANA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA. GABINETE INTEGRAL FABRICADO EN BASE DE POLÍMERO PLÁSTICO DE 13 MM COLOR BLANCO TOTALMENTE LISO DE CLORURO DE POLIVINILO RÍGIDO DE FÁCIL LIMPIEZA Y RESISTENTE A LA HUMEDAD; ANTIHONGOS EN COLOR BLANCO, MATERIAL IMPORTADO, INTEGRADO EN EL COSTADO IZQUIERDO DE LA UNIDAD, RESISTENTE A LOS SOLVENTES Y DETERGENTES QUE SE UTILIZAN PARA LA LIMPIEZA DE LA AMBULANCIA. QUE CUENTA CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDAR EQUIPO MÉDICO Y MATERIAL DE CURACIÓN CON PUERTAS CORREDIZAS DE LEXAN DE 3 MM MONTADA SOBRE CORREDERAS DE ALUMINIO CON FIELTRO PARA EVITAR VIBRACIONES DE LAS PUERTAS, UN (1) COMPARTIMIENTO PARA GUARDAR LA CAMILLA MARINA, CON CINTURONES DE SEGURIDAD, UNA (1) MESA DE TRABAJO.</p> <p>"BANCA FIJA TIPO "CHASSE-LONG". COLOCADA EN EL COSTADO DERECHO, FABRICADO EN BASE DE POLÍMERO PLÁSTICO DE 13 MM. DE ESPESOR DE CLORURO DE POLIVINILO RÍGIDO DE FÁCIL LIMPIEZA Y RESISTENTE A LA HUMEDAD Y ANTI HONGOS EN COLOR BLANCO, CON ASIENTO ABATIBLE INCLUYE: COLCHÓN CLÍNICO CON FORRO DE VINYL, UN COMPARTIMIENTO PARA LA CAMILLA RÍGIDA, Y CONTRAS PARA DOS PERSONAS SENTADAS SOBRE ESTE O UN PACIENTE ACOSTADO, RESPALDOS ANATÓMICOS CON CINTURÓN DE SEGURIDAD DE 3 PUNTOS PARA USO DEL PERSONAL MÉDICO Y PACIENTES.</p> <p>ASIENTO DE RCP, TAPIZADO EN VINIL DE ALTA RESISTENCIA SIN COSTURAS EN COLOR SKIN BLUE Y ASIENTO FABRICADO EN BASE DE POLÍMERO PLÁSTICO DE 13 MM DE ESPESOR DE CLORURO DE POLIVINILO RÍGIDO DE FÁCIL LIMPIEZA Y RESISTENTE A LA HUMEDAD, ANTIHONGOS EN COLOR BLANCO, MATERIAL IMPORTADO, ASIENTO A LO LARGO DE LA MAMPARA DONDE SE COLOCA EL TANQUE DE OXÍGENO CON UN MECANISMO DE RIELES QUE NOS PERMITE A TRAVÉS DE UNA PUERTA TENER ACCESO A ESTE, ESTO FACILITA LA COLOCACIÓN Y EXTRACCIÓN DEL TANQUE DE OXÍGENO CONTANDO ADEMÁS CON UNA PUERTA PARA ABRIR Y CERRAR DICHO TANQUE.</p> <p>PASAMANOS INTERIOR EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE, CON TRES PUNTOS DE APOYO, COLOCADO A TODO LO LARGO DE LA CABINA DE PACIENTES</p> <p>UN VENTILADOR CON CAPACIDAD DE 6 METROS CÚBICOS DE AIRE POR MINUTO.</p> <p>UN EXTRACTOR CON CAPACIDAD DE 6 METROS CÚBICOS DE AIRE POR MINUTO.</p> <p>DOS REJILLAS UNO PARA EL COMPARTIMIENTO DEL VENTILADOR Y EL OTRO PARA EL COMPARTIMIENTO DEL EXTRACTOR.</p> <p>DOS TOLVAS EXTERIORES DE VENTILACIÓN CROMADAS TIPO MARINO.</p> <p>PISO CON BASE DE MADERA Y LINÓLEUM TIPO</p>				 <p><b>GRUPO STELLA</b>  PRIMERO EL CLIENTE</p> <p>15 NOV 2022</p> <p><b>GERENCIA DE FLOTILLAS</b>  <b>GRUPO STELLA DE PUEBLA SAPI DE CV</b>  <b>GSP21032694A</b></p>
--	--	--	--	--	---	--

Matriz: Blvd. Atlxcáyotl No. 4000 A Teléfono: 222 168 0808 Colonia Emiliano Zapata 72824 San Andrés Cholula, Puebla.



		<p>AUTOMOTRIZ DE USO RUDO Y REMATES DE ALUMINIO. CAMILLA TIPO MARINA, TUBULAR GROMADO / VINILONA. TANQUE DE OXÍGENO FIJO TAMAÑO "M" CON MANÓMETRO Y REGULADOR DE FLUJO Y SALIDAS DISS. 2 TOMAS DE OXIGENO DE PARED PURITAN BENNET, FLUJÓMETRO Y VASO HUMIDIFICADOR.</p> <p><b>ACCESORIOS ESPECIALES</b>  <b>CONCEPTO</b>  ENCENDIDO AUTOMÁTICO DE LUZ INTERIOR (ÁREA MÉDICA) AL ABRIR LAS PUERTAS.  LA LLANTA DE REFACCIÓN SE CONSERVA EN SU UBICACIÓN ORIGINAL DE PLANTA. ELABORACIÓN DE CONSOLA EN EL ÁREA DEL OPERADOR, PARA ALOJAR LA SIRENA.  DEFENSA TRASERA TIPO ESCALÓN  RADIO MÓVIL DE COMUNICACIÓN  ALARMA DE REVERSA</p> <p><b>EQUIPO DE EMERGENCIA VIAL</b>  <b>CONCEPTO</b>  TORRETA DE 45" (119.0 CMS.) DE LARGO, 11.2" (28.4 CMS.) DE ANCHO, 2.5" (11.9 CMS.) DE ALTURA.  UN NIVEL, PERFIL BAJO, CON PROYECCIÓN DE LUZ A 360°, TOTALMENTE AERODINÁMICA. SISTEMA DE MONTAJE IRROMPIBLE PERMANENTE, ANTIOXIDANTE Y RESISTENTE A VIBRACIÓN, CON BASES AJUSTABLES CORREDIZAS, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO Y ANODIZADO, HERRAJES DE SUJECIÓN Y TORNILLERÍA ANTIOXIDO. CUBIERTA A BASE DE DOMOS DE POLICARBONATO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA.  SISTEMA DE SELLADO POR EMPAQUE PERIMETRAL Y TORNILLERÍA PARA EVITAR FILTRACIÓN DE HUMEDAD Y POLVO, ASÍ COMO PARA FACILITAR SU SERVICIO. COMPONENTES INTERNOS DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA A BASE DE CIRCUITOS Y TARJETAS ELECTRÓNICAS CON SISTEMAS OPTICOS DE GRAN EFICACIA EN PROYECCIÓN DE LUZ DE LED. - DOMOS SUPERIORES EN COLOR ROJO, (NO UTILIZA CABLES DE CONEXIÓN INTERNA). SIRENA ELECTRONICA DE 100 WATTS DE POTENCIA. TONOS PEMAENTES: WAIL, YELP, PIERCES Y HI-LO. CLAXON DE AIRE TIPO HORN (PATO). SISTEMA DE OPERACIÓN A MANOS LIBRES DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. INTERFASE PARA LA RETRANSMISIÓN DEL RADIO TRANSRECEPTOR. CONTROL MANUAL DE VOLUMEN DEL MICRÓFONO. DOS TIPOS DE OPERACIÓN MANUAL FIJO Y MOMENTÁNEO. BOCINA.</p> <p><b>LUCES EXTERIORES</b>  <b>CONCEPTO</b>  3 LED COLOR BLANCO (SCENA) 7X3" COLOCADAS UNA EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA, UNA EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA Y UNA.  EN LA PARTE TRASERA, COLOCADA COMO LUZ DE ESCENA.  6 LED COLOR ROJO 7X3" COLOCADAS, DOS EN LATERAL IZQUIERDO, DOS EN LATERAL DERECHO Y DOS EN LA PARTE TRASERA.</p> <p><b>ILUMINACIÓN INTERIOR</b>  <b>CONCEPTO</b></p>					  <b>GRUPO STELLA</b> PRIMERO EL CLIENTE <b>15 NOV 2022</b> <b>GERENCIA DE FLOTILLAS</b> <b>GRUPO STELLA DE PUEBLA SAPI DE CV</b> <b>GSP21032694A</b>
--	--	---	--	--	--	--	--

Matriz: Blvd. Atlixcáyotl No. 4000 A Teléfono: 222 168 0808 Colonia Emiliano Zapata 72824 San Andrés Cholula, Puebla.



		<p>6 LÁMPARAS INTERIORES CON DOMO DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL.  1 LÁMPARA PARA LA ILUMINACIÓN DE LA MESA DE TRABAJO.  INVERSOR DE CORRIENTE GRADO MEDICO CON CAPACIDAD DE 1500 WATTS.  INSTALACIÓN ELÉCTRICA 110 VOLTS.  EVAPORADOR TRASERO CON CAPACIDAD DE 28,000 BTU'S UN SISTEMA DE DOBLE BATERÍA. - LA UNIDAD ESTA EQUIPADA CON UN SISTEMA DE DOBLE BATERÍA QUE INCLUYE:  1) UN INTERRUPTOR CORTACORRIENTE.  2) UN ISOLADOR SELENOIDAL QUE REGULA LA CARGA DE LAS BATERÍAS (PRINCIPAL Y AUXILIAR). Y EVITA EL DRENADO DE LA BATERÍA PRINCIPAL A LA BATERÍA AUXILIAR CUANDO EL MOTOR DE LA UNIDAD SE ENCUENTRA APAGADO;  3) UNA BATERÍA AUXILIAR DE GEL,  4) UN CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA Y  5) FUSIBLES DE PROTECCIÓN POR CADA CIRCUITO.  CENTRO DE CARGA ESPECIAL PARA AMBULANCIAS MARCA ADR (SISTEMA ELECTRÓNICO DIGITAL) CONSTA DE TRES PARTES PARA CENTRALIZAR LOS PUNTOS DE CONEXIONES ESTE FABRICADO EN CIRCUITO IMPRESO (PVC) CON TECNOLOGÍA THT (THROUGH-HOLE TECHNOLOGY) SUS CARACTERÍSTICAS SON: VOLTÍMETRO DIGITAL. DICHO VOLTÍMETRO ESTÁ DISEÑADO PARA MONITOREAR EL ESTADO DE LA BATERÍA PRIMARIA, SECUNDARIA O AMBAS BATERÍAS, PROYECTANDO EL VALOR EN UNA PANTALLA LCD, MARGEN DE ERROR 0.5V +/-.  MONITOR DE ESTADO. ESTE MISMO ESTÁ DISEÑADO PARA PODER ESTAR MONITOREANDO EL ESTADO LÓGICO DE CADA UNO DE LOS FUSIBLES, ESTO NOS PERMITE IDENTIFICAR CUANDO UN FUSIBLE SE ENCUENTRA ABIERTO (DAÑADO), INDICANDO LA FALLA CON UN TESTIGO LUMINOSO, TESTIGO ACUSTICO O EN UNA PANTALLA LCD (SEGÚN MODELO), UNA VEZ QUE EL FUSIBLE DAÑADO SE REEMPLAZA EL SISTEMA CONTINUO CON EL MONITOREO. CARACTERÍSTICAS: CONSUMO EN REPOSO 20 WATTS. 10V MÍNIMO 15V MÁXIMO. 13 RELEVADORES DE IMPORTACIÓN DE DIFERENTES AMPERAJES. 2 CONTROLADORES DE INTENSIDAD PARA LUZ BAJA Y LUZ ALTA 50 WATTS MÁXIMO. 2 CONTROLES PWM (MODULACIÓN POR ANCHO DE PULSO) DE 50 WATTS MÁXIMO, ESTE SISTEMA PWM PERMITE VAREAR LA VELOCIDAD DE MOTORES Y PUEDE SER UTILIZADO PARA EXTRACTOR Y VENTILADOR (SEGÚN MODELO). CONECTORES AUTOMOTRICES. TODO LO MENCIONADO ESTÁ ALOJADO EN UNA BASE DE ALUMINIO EN CORTE LASER PARA PODER DISIPAR CALOR Y AYUDAR A UN MEJOR FUNCIONAMIENTO. CONTROL 1 (ÁREA DE PACIENTES) EL CONTROL 1 SE COMUNICA POR MEDIO DE INTERFAZ AL CENTRO DE CARGA. CONTANDO CON 9 BOTONES DIGITALES ON-OFF, PULSA ACTIVA PULSA DESACTIVA, CADA BOTÓN TIENE UN TESTIGO LUMINOSO Y ACÚSTICO. PANTALLA LCD QUE MUESTRA LOS TEXTOS DE CADA FUNCIÓN QUE SE REALICEN FUNCIONES: SEMÁFORO DE VIDA, LUZ BAJA, LUZ ALTA, EXTRACTOR, VENTILADOR, MESA DE TRABAJO, INVERSOR, SUCCIONADOR. TERMÓMETRO DIGITAL SENSOR QUE</p>				
--	--	--	--	--	--	--




15 NOV 2022

GERENCIA DE FLOTILLAS  
GRUPO STELLA DE PUEBLA SAPI DE CV  
GSP21032694A

Matriz: Blvd. Atlixcáyotl No. 4000 A Teléfono: 222 168 0808 Colonia Emiliano Zapata 72824 San Andrés Cholula, Puebla.



		<p>MONITOREA LA TEMPERATURA DEL ÁREA DE PACIENTES Y DESPLIEGA EL VALOR EN GRADOS CENTÍGRADOS EN LA PANTALLA ICD MARGEN DE ERROR 1 GRADO +/-.</p> <p>CONTROL 2 (ÁREA DE CONDUCTOR) ESTE MÓDULO MENCIONADO SE COMUNICA POR MEDIO DE INTERFAZ AL CENTRO DE CARGA, CONTANDO CON 9 BOTONES DIGITALES, ON-OFF PULSA ACTIVA -PULSA DESACTIVA, CADA BOTÓN TIENE UN TESTIGO LUMINOSO Y ACÚSTICO. PANTALLA LED QUE MUESTRA LOS TEXTOS DE CADA FUNCIÓN QUE SE REALICEN FUNCIONES: TORRETA, PERIMETRALES, FAROS DE HALÓGENO, ESCENA DERECHA, ESCENA TRASERA, ESCENA IZQUIERDA, INDICADOR PUERTA ABIERTA, VOLTÍMETRO DIGITAL.</p> <p>EXTINTOR.          TODO EL CABLEADO ES REALIZADO POR MEDIO DE CONDUCTORES CON CALIBRES PROTEGIDOS CON UN 15% MÁS A LA CARGA QUE TIENEN, CODIFICADOS A BASE DE COLORES, PROTEGIDOS POR MEDIO DE DUCTOS, TUBO FLEXIBLE CALIDAD AUTOMOTRIZ, Y GRUMMETS PASA CABLES.          4 LUCES DE LEDS COLOR CRISTAL EN FAROS Y CALAVERAS.</p> <p><b>EQUIPO MÉDICO CONCEPTO</b>          CAMILLA DESARROLLADA PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES EN LAS SITUACIONES DE RESCATE, AGILIZA LA ATENCIÓN Y PROPORCIONA ESFUERZO DE OPERACIÓN REDUCIDO. RUEDAS CON SISTEMA DE FRENO Y RUEDA DE 127 MM DE DIÁMETRO. RESPALDO AJUSTABLE EN SEIS POSICIONES. CAPACIDAD DE CARGA 300KG ESTRUCTURA DE DURALUMINIO TUBULAR, NO UTILIZAR SOLDADURA, MONTAJE Y FIJACIÓN A TRAVÉS DE ENCAJE, PASADOR ELÁSTICO Y TORNILLO. ASAS LATERALES BASCULANTES CON SISTEMA DE CIERRE AUTOMÁTICO. COLCHONETA REVESTIDA CON MATERIAL IMPERMEABLE, AUTO-EXTINGUIBLE, COSIDO ELECTRÓNICAMENTE. CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA FIJACIÓN DEL PACIENTE CON SISTEMA DE ENGANCHE AUTOMOTRIZ, SIENDO UN CONJUNTO 4 PUNTAS Y 2 CONJUNTOS 2 PUNTAS. SISTEMA DE SEGURIDAD AUTOMÁTICO QUE IMPIDE LA CAÍDA ACCIDENTAL. SISTEMA DE ANCLAJE COMPLETO PARA INSTALACIÓN EN AMBULANCIAS. PRODUCIDA DE ACUERDO CON EL VEHÍCULO A SER INSTALADO. SISTEMA DE RECOGIMIENTO BIARTICULADO, CONJUNTO DE PIERNAS INDEPENDIENTE QUE REDUCE EL ESFUERZO DE ENTRADA Y SALIDA DEL VEHÍCULO. CAPACIDAD DE CARGA: 300KG CAMILLA RÍGIDA CON SU COMPARTIMIENTO.          SISTEMA DE INMOVILIZACIÓN PEDIÁTRICA          KIT DE 6 COLLARINES          INMOVILIZADOR DE CRÁNEO.          KIT DE FÉRULAS ADULTO.          ARAÑA DE SUJECIÓN: ARAÑA 10 PUNTOS DE SUJECIÓN.          FÉRULA MOLDEABLE TABLILLA GRANDE Y CHICA DE 40X10CMYCHIA20X10CM.          FÉRULA MOLDEABLE TABLILLA GRANDE Y CHICA DE 40X10CMYCHIA20X10CM.          CHALECO DE EXTRACCIÓN.          FÉRULA MOLDEABLE DE ROLLO.</p>				 <p><b>GRUPO STELLA</b>          PRIMERO EL CLIENTE</p> <p>15 NOV 2022</p> <p>GERENCIA DE FLOTILLAS          GRUPO STELLA DE PUEBLA SAPI DE CV          GSP21032694A</p>
--	--	--	--	--	--	---

Matriz: Blvd. Atlxcáyotl No. 4000 A Teléfono: 222 168 0808 Colonia Emiliano Zapata 72824 San Andrés Cholula, Puebla.



		<p>OXIMETRO DE PULSO (2PIEZAS).          ASPIRADOR PORTÁTIL.          BAUMANOMETRO ANEROIDE PEDIÁTRICO ADULTO.          TORNQUETE ADULTO          MARTILLO PARA REFLEJOS: CABEZAL TRIANGULAR PARA UNA MEJOR EVALUACIÓN DE REFLEJOS MANGO CON PLANTA AGUDA PARA REFLEJO PLANTAR.          ESTUCHE DE DISECCIÓN.          SABANA TÉRMICA.          TERMÓMETRO DIGITAL.          LÁMPARA DE LED.          MOCHILA BOTIQUÍN CANGURO.          MOCHILA BOTIQUÍN.          MOCHILA MINI PACK          MOCHILA PARA TANQUE DE OXIGENO PORTÁTIL.          MOCHILA BOTIQUÍN DE PIERNA          CHALECO VIAL: CHALECO REFRACTIVO PARA LA TRIPULACIÓN          BOTIQUÍN MEDICO CONTIENE:          EXTINTOR: UN EXTINTOR PARA FUEGOS ABC          RECOLECTOR DE PUNZOCORTANTE: 1 PL-1 ROJO, POLIPROPILENO PARA PUNZOCORTANTE CAPACIDAD VOLUMEN: 1.7LTS. NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-087-ECOL-1995.          RECOLECTOR DE POLIPROPILENO PARA LÍQUIDOS: 1 PL-1 A AMARILLO, RECOLECTOR DE POLIPROPILENO PARA LÍQUIDOS VOLUMEN: 1.7ITS. NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-087-ECOI-1995.</p> <p>MARCA: FIAT          PROCEDENCIA: ITALIA</p>				
--	--	---	--	--	--	--

Todos son requisitos esenciales la falta de alguno de ellos será causa de descalificación

Firmada y sellada en todas y cada una de sus hojas, indicando nombre y puesto de la persona autorizada.

NOTA: El licitante deberá respetar y llenar el presente formato con toda la información solicitada, ya que en caso de no hacerlo así, será causa de descalificación. Este formato se presentará en WORD.

ATENTAMENTE  
 PUEBLA, PUEBLA A 15 DE NOVIEMBRE DE 2022

IVONNE TELLEZ PEÑAFLOR  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 GRUPO STELLA DE PUEBLA, S.A.P.I. DE C.V.

GRUPO STELLA  
 PRIMERO EL CLIENTE

15 NOV 2022

GERENCIA DE FLOTILLAS  
 GRUPO STELLA DE PUEBLA SAPI DE CV  
 GSP21032694A

Matriz: Blvd. Atlixcáyotl No. 4000 A Teléfono: 222 168 0808 Colonia Emiliano Zapata 72824 San Andrés Cholula, Puebla.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
 INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS GET-OMG-INV-182/2022  
 REFERENTE A VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA.

ANEXO

Formato para la presentación de la Propuesta Técnica.

DIRIGIDO A: GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
 INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS GET-OMG-INV-182/2022  
 REFERENTE A VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE.  
 PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS LESRING S.A. DE CV.							
CANTIDAD	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROPUESTA TÉCNICA DETALLADA	MARCA	CLAVE O MODELO	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTÍA
1	1	PZA	<p>(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):</p> <p>AMBULANCIA DE URGENCIAS BÁSICAS EN VAN 11.5 M3 DUCATO DIESEL AÑO 2022 TRANSMISION MANUAL</p> <p>FICHA TÉCNICA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 11.5 MANUAL 2022 CILINDRADA (CM3) / NÚMERO Y DISPOSICIÓN 2,287 CM3 / 4 EN LÍNEA</li> <li>• DIRECCIÓN CON ASISTENCIA HIDRÁULICA</li> <li>• TRANSMISIÓN MANUAL DE 6 VELOCIDADES +REVERSA</li> <li>• ALIMENTACIÓN INYECCIÓN DIRECTA TIPO "COMMON RAIL" DE CONTROL ELECTRÓNICO CON TURBOCOMPRESOR E INTERCOOLER</li> <li>• ALTERNADOR DE ALTA POTENCIA 180AMP</li> <li>• CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE 90 LITROS</li> <li>• MOTOR 2.3L 130 MULTIJET DIESEL</li> <li>• PLACA PROTECTORA DE CÁRTER</li> <li>• POTENCIA 130 HP @ 3,600RPM</li> <li>• TORQUE LB-PIE @ RPM 236 @1800</li> <li>• ATRACCIÓN DELANTERA</li> </ul> <p>LA AMBULANCIA DEBE CONTAR EL SIGUIENTE EQUIPO MÉDICO SIN COSTO EXTRA. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:</p> <p><b>CARROCERÍA</b>  <b>CONCEPTO</b>                      ELABORACIÓN DE ESTRUCTURA TUBULAR PARA LA COLOCACIÓN DE CHAROLAS Y SOPORTES METÁLICOS, PARA RECIBIR LAS LÁMPARAS DE ILUMINACIÓN INTERIOR, PASAMANO INTERIOR, Y EL TECHO DE FIBRA DE VIDRIO DE UNA SOLA PIEZA.                      2 PORTA VENOCISIS                      AISLAMIENTO TÉRMICO ENTRE PAREDES Y TECHO A BASE DE PLACAS DE FIBRA MINERAL.                      RECUBRIMIENTO INTERIOR EN FIBRA DE VIDRIO DE 3MM DE UNA SOLA PIEZA COLOR BLANCO TOTAL MENTE LISTO (PAREDES LATERALES, MAMPARA DIVISORIA Y TECHO).                      INSTALACIÓN DE MEDALLONES DE CRISTAL INASTILLABLE COLOR FLTRASOL EN LAS DOS PUERTAS TRASERAS.                      INSTALACIÓN DE VENTANA CON CRISTALES INASTILLABLES COLOR</p>	FIAT	2022	SEGÚN BASES	24 MESES EN VEHICULO Y 12 MESES EN CONVERSION




GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS GET-OMG-INV-182/2022  
REFERENTE A VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA.

		<p>FILTRASOL, EN LA PUERTA LATERAL ORIGINAL DEL VEHÍCULO.</p> <p><b>CABINA DE PACIENTES</b> <b>CONCEPTO</b> MAMPARA DIVISORIA ENTRE LA CABINA DEL CONDUCTOR Y LA CABINA DE PACIENTES, FABRICADA EN FABRICADA EN PERFIL DE 1X1 CAL.16 CON ACABADO EXTERIOR DE FIBRA DE VIDRIO DE 3MM, COLOR BLANCO TOTALMENTE LISO, CON VENTANA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA. GABINETE INTEGRAL FABRICADO EN BASE DE POLÍMERO PLÁSTICO DE 13 MM COLOR BLANCO TOTALMENTE LISO DE CLORURO DE POLIVINILO RÍGIDO DE FÁCIL LIMPIEZA Y RESISTENTE A LA HUMEDAD; ANTIHONGOS EN COLOR BLANCO, MATERIAL IMPORTADO, INTEGRADO EN EL COSTADO IZQUIERDO DE LA UNIDAD, RESISTENTE A LOS SOLVENTES Y DETERGENTES QUE SE UTILIZAN PARA LA LIMPIEZA DE LA AMBULANCIA. QUE CUENTA CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDAR EQUIPO MÉDICO Y MATERIAL DE CURACIÓN CON PUERTAS CORREDIZAS DE LEXAN DE 3 MM MONTADA SOBRE CORREDERAS DE ALUMINIO CON FIELTRO PARA EVITAR VIBRACIONES DE LAS PUERTAS, UN (1) COMPARTIMIENTO PARA GUARDAR LA CAMILLA MARINA, CON CINTURONES DE SEGURIDAD, UNA (1) MESA DE TRABAJO.</p> <p>"BANCA FIJA TIPO "CHASSE-LONG". COLOCADA EN EL COSTADO DERECHO, FABRICADO EN BASE DE POLÍMERO PLÁSTICO DE 13 MM. DE ESPESOR DE CLORURO DE POLIVINILO RÍGIDO DE FÁCIL LIMPIEZA Y RESISTENTE A LA HUMEDAD Y ANTI HONGOS EN COLOR BLANCO, CON ASIENTO ABATIBLE INCLUYE: COLCHÓN CLÍNICO CON FORRO DE VINYL, UN COMPARTIMIENTO PARA LA CAMILLA RÍGIDA, Y CONTRAS PARA DOS PERSONAS SENTADAS SOBRE ESTE O UN PACIENTE ACOSTADO, RESPALDOS ANATÓMICOS CON CINTURÓN DE SEGURIDAD DE 3 PUNTOS PARA USO DEL PERSONAL MÉDICO Y PACIENTES.</p> <p>ASIENTO DE RCP, TAPIZADO EN VINIL DE ALTA RESISTENCIA SIN COSTURAS EN COLOR SKIN BLUE Y ASIENTO FABRICADO EN BASE DE POLÍMERO PLÁSTICO DE 13 MM DE ESPESOR DE CLORURO DE POLIVINILO RÍGIDO DE FÁCIL LIMPIEZA Y RESISTENTE A LA HUMEDAD, ANTIHONGOS EN COLOR BLANCO, MATERIAL IMPORTADO, ASIENTO A LO LARGO DE LA MAMPARA DONDE SE COLOCA EL TANQUE DE OXÍGENO CON UN MECANISMO DE RIELES QUE NOS PERMITE A TRAVÉS DE UNA PUERTA TENER ACCESO A ESTE, ESTO FACILITA LA COLOCACIÓN Y EXTRACCIÓN DEL TANQUE DE OXÍGENO CONTANDO ADEMÁS CON UNA PUERTA PARA ABRIR Y CERRAR DICHO TANQUE.</p> <p>PASAMANOS INTERIOR EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE, CON TRES PUNTOS DE APOYO, COLOCADO A TODO LO LARGO DE LA CABINA DE PACIENTES UN VENTILADOR CON CAPACIDAD DE 6 METROS CÚBICOS DE AIRE POR MINUTO. UN EXTRACTOR CON CAPACIDAD DE 6 METROS CÚBICOS DE AIRE POR MINUTO. DOS REJILLAS UNO PARA EL COMPARTIMIENTO DEL VENTILADOR Y EL OTRO PARA EL COMPARTIMIENTO DEL EXTRACTOR. DOS TOLVAS EXTERIORES DE VENTILACIÓN CROMADAS TIPO MARINO. PISO CON BASE DE MADERA Y LINÓLEUM TIPO AUTOMOTRIZ DE USO RUDDO Y REMATES DE ALUMINIO. CAMILLA TIPO MARINA, TUBULAR CROMADO / VINILONA.</p>				
--	--	---	--	--	--	--



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS GET-OMG-INV-182/2022  
REFERENTE A VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA.

		<p>TANQUE DE OXÍGENO FIJO TAMAÑO "M" CON MANÓMETRO Y REGULADOR DE FLUJO Y SALIDAS DISS. 2 TOMAS DE OXIGENO DE PARED PURITAN BENNET, FLUJÓMETRO Y VASO HUMIDIFICADOR.</p> <p><b>ACCESORIOS ESPECIALES</b> <b>CONCEPTO</b> ENCENDIDO AUTOMÁTICO DE LUZ INTERIOR (ÁREA MÉDICA) AL ABRIR LAS PUERTAS. LA LLANTA DE REFACCIÓN SE CONSERVA EN SU UBICACIÓN ORIGINAL DE PLANTA. ELABORACIÓN DE CONSOLA EN EL ÁREA DEL OPERADOR, PARA ALOJAR LA SIRENA. DEFENSA TRASERA TIPO ESCALÓN RADIO MÓVIL DE COMUNICACIÓN ALARMA DE REVERSA</p> <p><b>EQUIPO DE EMERGENCIA VIAL</b> <b>CONCEPTO</b> TORRETA DE 45" (119.0 CMS.) DE LARGO, 11.2" (28.4 CMS.) DE ANCHO, 2.5" (11.9 CMS.) DE ALTURA. UN NIVEL, PERFIL BAJO, CON PROYECCIÓN DE LUZ A 360°, TOTALMENTE AERODINÁMICA. SISTEMA DE MONTAJE IRROMPIBLE PERMANENTE, ANTIOXIDANTE Y RESISTENTE A VIBRACIÓN, CON BASES AJUSTABLES CORREDIZAS, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO Y ANODIZADO, HERRAJES DE SUJECIÓN Y TORNILLERÍA ANTIOXIDO. CUBIERTA A BASE DE DOMOS DE POLICARBONATO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA. SISTEMA DE SELLADO POR EMPAQUE PERIMETRAL Y TORNILLERÍA PARA EVITAR FILTRACIÓN DE HUMEDAD Y POLVO, ASÍ COMO PARA FACILITAR SU SERVICIO. COMPONENTES INTERNOS DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA A BASE DE CIRCUITOS Y TARJETAS ELECTRÓNICAS CON SISTEMAS OPTICOS DE GRAN EFICACIA EN PROYECCIÓN DE LUZ DE LED. - DOMOS SUPERIORES EN COLOR ROJO, (NO UTILIZA CABLES DE CONEXIÓN INTERNA). SIRENA ELECTRONICA DE 100 WATTS DE POTENCIA. TONOS PEMANENTES: WAIL, YELP, PIERCES Y HI-LO. CLAXON DE AIRE TIPO HORN (PATO). SISTEMA DE OPERACIÓN A MANOS LIBRES DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. INTERFASE PARA LA RETRANSMISIÓN DEL RADIO TRANSRECEPTOR. CONTROL MANUAL DE VOLUMEN DEL MICRÓFONO. DOS TIPOS DE OPERACIÓN MANUAL FIJO Y MOMENTÁNEO. BOCINA.</p> <p><b>LUCES EXTERIORES</b> <b>CONCEPTO</b> 3 LED COLOR BLANCO (SCENA) 7X3" COLOCADAS UNA EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA, UNA EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA Y UNA EN LA PARTE TRASERA, COLOCADA COMO LUZ DE ESCENA. 6 LED COLOR ROJO 7X3" COLOCADAS, DOS EN LATERAL IZQUIERDO, DOS EN LATERAL DERECHO Y DOS EN LA PARTE TRASERA.</p> <p><b>ILUMINACIÓN INTERIOR</b> <b>CONCEPTO</b> 6 LÁMPARAS INTERIORES CON DOMO DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL. 1 LÁMPARA PARA LA ILUMINACIÓN DE LA MESA DE TRABAJO. INVERSOR DE CORRIENTE GRADO MEDICO CON CAPACIDAD DE 1500 WATTS.</p>				
--	--	---	--	--	--	--



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS GET-OMG-INV-182/2022  
REFERENTE A VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA.

		<p>INSTALACIÓN ELÉCTRICA 110 VOLTS.  EVAPORADOR TRASERO CON CAPACIDAD DE 28,000 BTU'S  UN SISTEMA DE DOBLE BATERÍA. - LA UNIDAD ESTA EQUIPADA CON UN SISTEMA DE DOBLE BATERÍA QUE INCLUYE:  1) UN INTERRUPTOR CORTACORRIENTE.  2) UN ISOLADOR SELENOIDAL QUE REGULA LA CARGA DE LAS BATERÍAS (PRINCIPAL Y AUXILIAR). Y EVITA EL DRENADO DE LA BATERÍA PRINCIPAL A LA BATERÍA AUXILIAR CUANDO EL MOTOR DE LA UNIDAD SE ENCUENTRA APAGADO;  3) UNA BATERÍA AUXILIAR DE GEL,  4) UN CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA Y  5) FUSIBLES DE PROTECCIÓN POR CADA CIRCUITO.  CENTRO DE CARGA ESPECIAL PARA AMBULANCIAS MARCA ADR (SISTEMA ELECTRÓNICO DIGITAL) CONSTA DE TRES PARTES PARA CENTRALIZAR LOS PUNTOS DE CONEXIONES ESTE FABRICADO EN CIRCUITO IMPRESO (PVC) CON TECNOLOGÍA THT (THROUGH-HOLE TECNOLOGY) SUS CARACTERÍSTICAS SON: VOLTÍMETRO DIGITAL. DICHO VOLTÍMETRO ESTÁ DISEÑADO PARA MONITOREAR EL ESTADO DE LA BATERÍA PRIMARIA, SECUNDARIA O AMBAS BATERÍAS, PROYECTANDO EL VALOR EN UNA PANTALLA LCD, MARGEN DE ERROR 0.5V +/-.  MONITOR DE ESTADO. ESTE MISMO ESTÁ DISEÑADO PARA PODER ESTAR MONITOREANDO EL ESTADO LÓGICO DE CADA UNO DE LOS FUSIBLES, ESTO NOS PERMITE IDENTIFICAR CUANDO UN FUSIBLE SE ENCUENTRA ABIERTO (DAÑADO), INDICANDO LA FALLA CON UN TESTIGO LUMINOSO, TESTIGO ACUSTICO O EN UNA PANTALLA LCD (SEGÚN MODELO), UNA VEZ QUE EL FUSIBLE DAÑADO SE REEMPLAZA EL SISTEMA CONTINUO CON EL MONITOREO. CARACTERÍSTICAS: CONSUMO EN REPOSO 20 WATTS. 10V MÍNIMO 15V MÁXIMO. 13 RELEVADORES DE IMPORTACIÓN DE DIFERENTES AMPERAJES. 2 CONTROLADORES DE INTENSIDAD PARA LUZ BAJA Y LUZ ALTA 50 WATTS MÁXIMO. 2 CONTROLES PWM (MODULACIÓN POR ANCHO DE PULSO) DE 50 WATTS MÁXIMO, ESTE SISTEMA PWM PERMITE VAREAR LA VELOCIDAD DE MOTORES Y PUEDE SER UTILIZADO PARA EXTRACTOR Y VENTILADOR (SEGÚN MODELO). CONECTORES AUTOMOTRICES. TODO LO MENCIONADO ESTÁ ALOJADO EN UNA BASE DE ALUMINIO EN CORTE LASER PARA PODER DISIPAR CALOR Y AYUDAR A UN MEJOR FUNCIONAMIENTO.  CONTROL 1 (ÁREA DE PACIENTES) EL CONTROL 1 SE COMUNICA POR MEDIO DE INTERFAZ AL CENTRO DE CARGA. CONTANDO CON 9 BOTONES DIGITALES ON-OFF, PULSA ACTIVA PULSA DESACTIVA, CADA BOTÓN TIENE UN TESTIGO LUMINOSO Y ACÚSTICO. PANTALLA LCD QUE MUESTRA LOS TEXTOS DE CADA FUNCIÓN QUE SE REALICEN FUNCIONES: SEMÁFORO DE VIDA, LUZ BAJA, LUZ ALTA, EXTRACTOR, VENTILADOR, MESA DE TRABAJO, INVERSOR, SUCCIONADOR. TERMÓMETRO DIGITAL SENSOR QUE MONITOREA LA TEMPERATURA DEL ÁREA DE PACIENTES Y DESPLIEGA EL VALOR EN GRADOS CENTÍGRADOS EN LA PANTALLA LCD MARGEN DE ERROR 1 GRADO +/-.  CONTROL 2 (ÁREA DE CONDUCTOR) ESTE MÓDULO MENCIONADO SE COMUNICA POR MEDIO DE INTERFAZ AL CENTRO DE CARGA, CONTANDO CON 9 BOTONES DIGITALES, ON-OFF PULSA ACTIVA -PULSA DESACTIVA, CADA BOTÓN TIENE UN TESTIGO LUMINOSO Y ACÚSTICO. PANTALLA LED QUE MUESTRA LOS TEXTOS DE CADA FUNCIÓN QUE SE REALICEN FUNCIONES: TORRETA, PERIMETRALES, FAROS DE HALÓGENO, ESCENA DERECHA, ESCENA TRASERA, ESCENA IZQUIERDA, INDICADOR PUERTA ABIERTA, VOLTÍMETRO DIGITAL.</p>				
--	--	--	--	--	--	--



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

www.lessing.com

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS GET-OMG-INV-182/2022  
REFERENTE A VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA.

		<p>EXTINTOR.          TODO EL CABLEADO ES REALIZADO POR MEDIO DE CONDUCTORES CON CALIBRES PROTEGIDOS CON UN 15% MÁS A LA CARGA QUE TIENEN, CODIFICADOS A BASE DE COLORES, PROTEGIDOS POR MEDIO DE DUCTOS, TUBO FLEXIBLE CALIDAD AUTOMOTRIZ, Y GRUMMETS PASA CABLES.          4 LUCES DE LEDS COLOR CRISTAL EN FAROS Y CALAVERAS.</p> <p><b>EQUIPO MÉDICO CONCEPTO</b>          CAMILLA DESARROLLADA PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES EN LAS SITUACIONES DE RESCATE, AGILIZA LA ATENCIÓN Y PROPORCIONA ESFUERZO DE OPERACIÓN REDUCIDO. RUEDAS CON SISTEMA DE FRENO Y RUEDA DE 127 MM DE DIÁMETRO. RESPALDO AJUSTABLE EN SEIS POSICIONES. CAPACIDAD DE CARGA 300KG ESTRUCTURA DE DURALUMINIO TUBULAR, NO UTILIZAR SOLDADURA, MONTAJE Y FIJACIÓN A TRAVÉS DE ENCAJE, PASADOR ELÁSTICO Y TORNILLO. ASAS LATERALES BASCULANTES CON SISTEMA DE CIERRE AUTOMÁTICO. COLCHONETA REVESTIDA CON MATERIAL IMPERMEABLE, AUTO-EXTINGUIBLE, COSIDO ELECTRÓNICAMENTE. CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA FIJACIÓN DEL PACIENTE CON SISTEMA DE ENGANCHE AUTOMOTRIZ, SIENDO UN CONJUNTO 4 PUNTAS Y 2 CONJUNTOS 2 PUNTAS. SISTEMA DE SEGURIDAD AUTOMÁTICO QUE IMPIDE LA CAÍDA ACCIDENTAL. SISTEMA DE ANCLAJE COMPLETO PARA INSTALACIÓN EN AMBULANCIAS. PRODUCIDA DE ACUERDO CON EL VEHÍCULO A SER INSTALADO. SISTEMA DE RECOGIMIENTO BIARTICULADO, CONJUNTO DE PIERNAS INDEPENDIENTE QUE REDUCE EL ESFUERZO DE ENTRADA Y SALIDA DEL VEHÍCULO. CAPACIDAD DE CARGA: 300KG CAMILLA RÍGIDA CON SU COMPARTIMIENTO.          SISTEMA DE INMOVILIZACIÓN PEDIÁTRICA          KIT DE 6 COLLARINES          INMOVILIZADOR DE CRÁNEO.          KIT DE FÉRULAS ADULTO.          ARAÑA DE SUJECIÓN: ARAÑA 10 PUNTOS DE SUJECIÓN.          FÉRULA MOLDEABLE TABLILLA GRANDE Y CHICA DE 40X10CMYCHIA20X10CM.          FÉRULA MOLDEABLE TABLILLA GRANDE Y CHICA DE 40X10CMYCHIA20X10CM.          CHALECO DE EXTRACCIÓN.          FÉRULA MOLDEABLE DE ROLLO.          OXIMETRO DE PULSO (2PIEZAS).          ASPIRADOR PORTÁTIL.          BAUMANOMETRO ANEROIDE PEDIÁTRICO ADULTO.          TORNIQUETE ADULTO          MARTILLO PARA REFLEJOS: CABEZAL TRIANGULAR PARA UNA MEJOR EVALUACIÓN DE REFLEJOS MANGO CON PLANTA AGUDA PARA REFLEJO PLANTAR.          ESTUCHE DE DISECCIÓN.          SABANA TÉRMICA.          TERMÓMETRO DIGITAL.          LÁMPARA DE LED.          MOCHILA BOTIQUÍN CANGURO.          MOCHILA BOTIQUÍN.          MOCHILA MINI PACK          MOCHILA PARA TANQUE DE OXIGENO PORTÁTIL.</p>				
--	--	---	--	--	--	--



LESSIRG

www.lessirg.com

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS GET-OMG-INV-182/2022  
REFERENTE A VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA.


		MOCHILA BOTIQUÍN DE PIERNA CHALECO VIAL: CHALECO REFRACTIVO PARA LA TRIPULACIÓN BOTIQUÍN MEDICO CONTIENE: EXTINTOR: UN EXTINTOR PARA FUEGOS ABC RECOLECTOR DE PUNZOCORTANTE: 1 PL-1 ROJO, POLIPROPILENO PARA PUNZOCORTANTE CAPACIDAD VOLUMEN: 1.7LTS. NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-087-ECOL-1995. RECOLECTOR DE POLIPROPILENO PARA LÍQUIDOS: 1 PL-1 A AMARILLO, RECOLECTOR DE POLIPROPILENO PARA LÍQUIDOS VOLUMEN: 1.7ITS. NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-087-ECOI-1995.  MARCA: FIAT PROCEDENCIA: ITALIA				
--	--	---	--	--	--	--

Todos son requisitos esenciales la falta de alguno de ellos será causa de descalificación

Firmada y sellada en todas y cada una de sus hojas, indicando nombre y puesto de la persona autorizada.


NOTA: El licitante deberá respetar y llenar el presente formato con toda la información solicitada, ya que en caso de no hacerlo así, será causa de descalificación. Este formato se presentará en WORD.

ATENTAMENTE  
TEPEACA, PUEBLA A 15 DE NOVIEMBRE DE 2022




---

LIC. GRISEL RIVERA BONILLA  
REPRESENTANTE LEGAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
 INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS GET-OMG-INV-182/2022  
 REFERENTE A VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA.

**ANEXO B**


Formato para la presentación de la Propuesta Técnica.

**DIRIGIDO A: GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**  
**INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS GET-OMG-INV-182/2022**  
**REFERENTE A VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE.**  
**PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA**

licitante: FERCOM DE PUEBLA, S.A. DE C.V.


PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROPUESTA TÉCNICA DETALLADA	MARCA	CLAVE O MODELO	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTÍA
1	1	PZA	<p>(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):</p> <p>AMBULANCIA DE URGENCIAS BÁSICAS EN VAN 11.5 M3 DUCATO DIESEL AÑO 2022 TRANSMISION MANUAL</p> <p>FICHA TÉCNICA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 11.5 MANUAL 2022 CILINDRADA (CM3) / NÚMERO Y DISPOSICIÓN 2,287 CM3 / 4 EN LÍNEA</li> <li>• DIRECCIÓN CON ASISTENCIA HIDRÁULICA</li> <li>• TRANSMISIÓN MANUAL DE 6 VELOCIDADES +REVERSA</li> <li>• ALIMENTACIÓN INYECCIÓN DIRECTA TIPO "COMMON RAIL" DE CONTROL ELECTRÓNICO CON TURBOCOMPRESOR E INTERCOOLER</li> <li>• ALTERNADOR DE ALTA POTENCIA 180AMP</li> <li>• CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE 90 LITROS</li> <li>• MOTOR 2.3L 130 MULTIJET DIESEL</li> <li>• PLACA PROTECTORA DE CÁRTER</li> <li>• POTENCIA 130 HP @ 3,600RPM</li> <li>• TORQUE LB-PIE @ RPM 236 @1800</li> <li>• ATRACCIÓN DELANTERA</li> </ul> <p>LA AMBULANCIA DEBE CONTAR EL SIGUIENTE EQUIPO MÉDICO SIN COSTO EXTRA. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:</p> <p><b>CARROCERÍA</b>  <b>CONCEPTO</b>          ELABORACIÓN DE ESTRUCTURA TUBULAR PARA LA COLOCACIÓN DE CHAROLAS Y SOPORTES METÁLICOS, PARA RECIBIR LAS LÁMPARAS DE ILUMINACIÓN INTERIOR, PASAMANO INTERIOR, Y EL TECHO DE FIBRA DE VIDRIO DE UNA SOLA PIEZA.          2 PORTA VENOCLISIS          AISLAMIENTO TÉRMICO ENTRE PAREDES Y TECHO A BASE DE PLACAS DE FIBRA MINERAL.          RECUBRIMIENTO INTERIOR EN FIBRA DE VIDRIO DE 3MM DE UNA SOLA PIEZA COLOR BLANCO TOTAL MENTE LISTO (PAREDES LATERALES, MAMPARA DIVISORIA Y TECHO).          INSTALACIÓN DE MEDALLONES DE CRISTAL INASTILLABLE</p>	FIAT	2022	15 DIAS DIAS H. POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO	24 MESES EN VEHICULO Y 12 MESES EN CONVERSION





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS GET-OMG-INV-182/2022  
REFERENTE A VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA.


		<p>COLOR FLTRASOL EN LAS DOS PUERTAS TRASERAS. INSTALACIÓN DE VENTANA CON CRISTALES INASTILLABLES COLOR FILTRASOL, EN LA PUERTA LATERAL ORIGINAL DEL VEHÍCULO.</p> <p><b>CABINA DE PACIENTES</b> <b>CONCEPTO</b> MAMPARA DIVISORIA ENTRE LA CABINA DEL CONDUCTOR Y LA CABINA DE PACIENTES, FABRICADA EN FABRICADA EN PERFIL DE 1X1 CAL.16 CON ACABADO EXTERIOR DE FIBRA DE VIDRIO DE 3MM, COLOR BLANCO TOTALMENTE LISO, CON VENTANA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA. GABINETE INTEGRAL FABRICADO EN BASE DE POLÍMERO PLÁSTICO DE 13 MM COLOR BLANCO TOTALMENTE LISO DE CLORURO DE POLIVINILO RÍGIDO DE FÁCIL LIMPIEZA Y RESISTENTE A LA HUMEDAD; ANTIHONGOS EN COLOR BLANCO, MATERIAL IMPORTADO, INTEGRADO EN EL COSTADO IZQUIERDO DE LA UNIDAD, RESISTENTE A LOS SOLVENTES Y DETERGENTES QUE SE UTILIZAN PARA LA LIMPIEZA DE LA AMBULANCIA. QUE CUENTA CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDAR EQUIPO MÉDICO Y MATERIAL DE CURACIÓN CON PUERTAS CORREDIZAS DE LEXAN DE 3 MM MONTADA SOBRE CORREDERAS DE ALUMINIO CON FIELTRO PARA EVITAR VIBRACIONES DE LAS PUERTAS, UN (1) COMPARTIMIENTO PARA GUARDAR LA CAMILLA MARINA, CON CINTURONES DE SEGURIDAD, UNA (1) MESA DE TRABAJO.</p> <p>"BANCA FIJA TIPO "CHASSE-LONG". COLOCADA EN EL COSTADO DERECHO, FABRICADO EN BASE DE POLÍMERO PLÁSTICO DE 13 MM. DE ESPESOR DE CLORURO DE POLIVINILO RÍGIDO DE FÁCIL LIMPIEZA Y RESISTENTE A LA HUMEDAD Y ANTI HONGOS EN COLOR BLANCO, CON ASIENTO ABATIBLE INCLUYE: COLCHÓN CLÍNICO CON FORRO DE VINYL, UN COMPARTIMIENTO PARA LA CAMILLA RÍGIDA, Y CONTRAS PARA DOS PERSONAS SENTADAS SOBRE ESTE O UN PACIENTE ACOSTADO, RESPALDOS ANATÓMICOS CON CINTURÓN DE SEGURIDAD DE 3 PUNTOS PARA USO DEL PERSONAL MÉDICO Y PACIENTES.</p> <p>ASIENTO DE RCP, TAPIZADO EN VINIL DE ALTA RESISTENCIA SIN COSTURAS EN COLOR SKIN BLUE Y ASIENTO FABRICADO EN BASE DE POLÍMERO PLÁSTICO DE 13 MM DE ESPESOR DE CLORURO DE POLIVINILO RÍGIDO DE FÁCIL LIMPIEZA Y RESISTENTE A LA HUMEDAD, ANTI HONGOS EN COLOR BLANCO, MATERIAL IMPORTADO, ASIENTO A LO LARGO DE LA MAMPARA DONDE SE COLOCA EL TANQUE DE OXÍGENO CON UN MECANISMO DE RIELES QUE NOS PERMITE A TRAVÉS DE UNA PUERTA TENER ACCESO A ESTE, ESTO FACILITA LA COLOCACIÓN Y EXTRACCIÓN DEL TANQUE DE OXÍGENO CONTANDO ADEMÁS CON UNA PUERTA PARA ABRIR Y</p>				
--	--	---	--	--	--	--

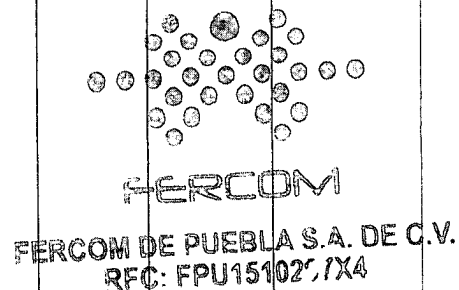





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS GET-OMG-INV-182/2022  
REFERENTE A VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA.

		<p>CERRAR DICHO TANQUE. PASAMANOS INTERIOR EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE, CON TRES PUNTOS DE APOYO, COLOCADO A TODO LO LARGO DE LA CABINA DE PACIENTES UN VENTILADOR CON CAPACIDAD DE 6 METROS CÚBICOS DE AIRE POR MINUTO. UN EXTRACTOR CON CAPACIDAD DE 6 METROS CÚBICOS DE AIRE POR MINUTO. DOS REJILLAS UNO PARA EL COMPARTIMIENTO DEL VENTILADOR Y EL OTRO PARA EL COMPARTIMIENTO DEL EXTRACTOR. DOS TOLVAS EXTERIORES DE VENTILACIÓN CROMADAS TIPO MARINO. PISO CON BASE DE MADERA Y LINÓLEUM TIPO AUTOMOTRIZ DE USO RUDO Y REMATES DE ALUMINIO. CAMILLA TIPO MARINA, TUBULAR CROMADO / VINILONA. TANQUE DE OXÍGENO FIO TAMAÑO "M" CON MANÓMETRO Y REGULADOR DE FLUJO Y SALIDAS DISS. 2 TOMAS DE OXIGENO DE PARED PURITAN BENNET, FLUJÓMETRO Y VASO HUMIDIFICADOR.</p> <p><b>ACCESORIOS ESPECIALES</b> <b>CONCEPTO</b> ENCENDIDO AUTOMÁTICO DE LUZ INTERIOR (ÁREA MÉDICA) AL ABRIR LAS PUERTAS. LA LLANTA DE REFACCIÓN SE CONSERVA EN SU UBICACIÓN ORIGINAL DE PLANTA. ELABORACIÓN DE CONSOLA EN EL ÁREA DEL OPERADOR, PARA ALOJAR LA SIRENA. DEFENSA TRASERA TIPO ESCALÓN RADIO MÓVIL DE COMUNICACIÓN ALARMA DE REVERSA</p> <p><b>EQUIPO DE EMERGENCIA VIAL</b> <b>CONCEPTO</b> TORRETA DE 45" (119.0 CMS.) DE LARGO, 11.2" (28.4 CMS.) DE ANCHO, 2.5" (11.9 CMS.) DE ALTURA. UN NIVEL, PERFIL BAJO, CON PROYECCIÓN DE LUZ A 360°, TOTALMENTE AERODINÁMICA. SISTEMA DE MONTAJE IRROMPIBLE PERMANENTE, ANTIOXIDANTE Y RESISTENTE A VIBRACIÓN, CON BASES AJUSTABLES CORREDIZAS, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO Y ANODIZADO, HERRAJES DE SUJECIÓN Y TORNILLERÍA ANTIOXIDO. CUBIERTA A BASE DE DOMOS DE POLICARBONATO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA. SISTEMA DE SELLADO POR EMPAQUE PERIMETRAL Y TORNILLERÍA PARA EVITAR FILTRACIÓN DE HUMEDAD Y POLVO, ASÍ COMO PARA FACILITAR SU SERVICIO. COMPONENTES INTERNOS DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA A BASE DE CIRCUITOS Y TARJETAS ELECTRÓNICAS CON SISTEMAS OPTICOS DE GRAN EFICACIA EN PROYECCIÓN DE LUZ DE LED. - DOMOS SUPERIORES EN COLOR ROJO, (NO UTILIZA CABLES DE CONEXIÓN INTERNA).</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

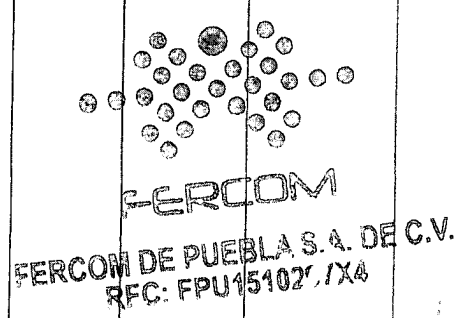





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS GET-OMG-INV-182/2022  
REFERENTE A VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA.

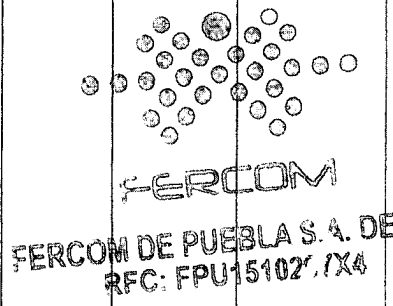		<p>SIRENA ELECTRONICA DE 100 WATTS DE POTENCIA. TONOS PEMANENTES: WAIL, YELP, PIERCES Y HI-LO. CLAXON DE AIRE TIPO HORN (PATO). SISTEMA DE OPERACIÓN A MANOS LIBRES DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. INTERFASE PARA LA RETRANSMISIÓN DEL RADIO TRANSRECEPTOR. CONTROL MANUAL DE VOLUMEN DEL MICRÓFONO. DOS TIPOS DE OPERACIÓN MANUAL FIJO Y MOMENTÁNEO. BOCINA.</p> <p><b>LUCES EXTERIORES</b> <b>CONCEPTO</b> 3 LED COLOR BLANCO (SCENA) 7X3" COLOCADAS UNA EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA, UNA EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA Y UNA. EN LA PARTE TRASERA, COLOCADA COMO LUZ DE ESCENA. 6 LED COLOR ROJO 7X3" COLOCADAS, DOS EN LATERAL IZQUIERDO, DOS EN LATERAL DERECHO Y DOS EN LA PARTE TRASERA.</p> <p><b>ILUMINACIÓN INTERIOR</b> <b>CONCEPTO</b> 6 LÁMPARAS INTERIORES CON DOMO DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL. 1 LÁMPARA PARA LA ILUMINACIÓN DE LA MESA DE TRABAJO. INVERSOR DE CORRIENTE GRADO MEDICO CON CAPACIDAD DE 1500 WATTS. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 110 VOLTS. EVAPORADOR TRASERO CON CAPACIDAD DE 28,000 BTU'S UN SISTEMA DE DOBLE BATERÍA. - LA UNIDAD ESTA EQUIPADA CON UN SISTEMA DE DOBLE BATERÍA QUE INCLUYE: 1) UN INTERRUPTOR CORTACORRIENTE. 2) UN ISOLADOR SELENOIDAL QUE REGULA LA CARGA DE LAS BATERÍAS (PRINCIPAL Y AUXILIAR). Y EVITA EL DRENADO DE LA BATERÍA PRINCIPAL A LA BATERÍA AUXILIAR CUANDO EL MOTOR DE LA UNIDAD SE ENCUENTRA APAGADO; 3) UNA BATERÍA AUXILIAR DE GEL, 4) UN CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA Y 5) FUSIBLES DE PROTECCIÓN POR CADA CIRCUITO. CENTRO DE CARGA ESPECIAL PARA AMBULANCIAS MARCA ADR (SISTEMA ELECTRÓNICO DIGITAL) CONSTA DE TRES PARTES PARA CENTRALIZAR LOS PUNTOS DE CONEXIONES ESTE FABRICADO EN CIRCUITO IMPRESO (PVC) CON TECNOLOGÍA THT (THROUGH-HOLE TECNOLOGY) SUS CARACTERÍSTICAS SON: VOLTÍMETRO DIGITAL. DICHO VOLTÍMETRO ESTÁ DISEÑADO PARA MONITOREAR EL ESTADO DE LA BATERÍA PRIMARIA, SECUNDARIA O AMBAS BATERÍAS. PROYECTANDO EL VALOR EN UNA PANTALLA LCD, MARGEN DE ERROR 0.5V +/-. MONITOR DE ESTADO. ESTE MISMO ESTÁ DISEÑADO</p>				
--	--	---	--	--	--	--



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS GET-OMG-INV-182/2022  
REFERENTE A VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA.

		<p>PARA PODER ESTAR MONITOREANDO EL ESTADO LÓGICO DE CADA UNO DE LOS FUSIBLES, ESTO NOS PERMITE IDENTIFICAR CUANDO UN FUSIBLE SE ENCUENTRA ABIERTO (DAÑADO), INDICANDO LA FALLA CON UN TESTIGO LUMINOSO, TESTIGO ACUSTICO O EN UNA PANTALLA LCD (SEGÚN MODELO), UNA VEZ QUE EL FUSIBLE DAÑADO SE REEMPLAZA EL SISTEMA CONTINUO CON EL MONITOREO. CARACTERÍSTICAS: CONSUMO EN REPOSO 20 WATTS. 10V MÍNIMO 15V MAXIMO. 13 RELEVADORES DE IMPORTACIÓN DE DIFERENTES AMPERAJES. 2 CONTROLADORES DE INTENSIDAD PARA LUZ BAJA Y LUZ ALTA 50 WATTS MAXIMO. 2 CONTROLES PWM (MODULACIÓN POR ANCHO DE PULSO) DE 50 WATTS MÁXIMO, ESTE SISTEMA PWM PERMITE VAREAR LA VELOCIDAD DE MOTORES Y PUEDE SER UTILIZADO PARA EXTRACTOR Y VENTILADOR (SEGÚN MODELO). CONECTORES AUTOMOTRICES. TODO LO MENCIONADO ESTÁ ALOJADO EN UNA BASE DE ALUMINIO EN CORTE LASER PARA PODER DISIPAR CALOR Y AYUDAR A UN MEJOR FUNCIONAMIENTO. CONTROL 1 (ÁREA DE PACIENTES) EL CONTROL 1 SE COMUNICA POR MEDIO DE INTERFAZ AL CENTRO DE CARGA. CONTANDO CON 9 BOTONES DIGITALES ON-OFF, PULSA ACTIVA PULSA DESACTIVA, CADA BOTÓN TIENE UN TESTIGO LUMINOSO Y ACÚSTICO. PANTAILA ICD QUE MUESTRA LOS TEXTOS DE CADA FUNCIÓN QUE SE REALICEN FUNCIONES: SEMÁFORO DE VIDA, LUZ BAJA, LUZ AITA, EXTRACTOR, VENTILADOR, MESA DE TRABAJO, INVERSOR, SUCCIONADOR. TERMÓMETRO DIGITAL SENSOR QUE MONITOREA LA TEMPERATURA DEL ÁREA DE PACIENTES Y DESPLIEGA EL VALOR EN GRADOS CENTÍGRADOS EN LA PANTALLA ICD MARGEN DE ERROR 1 GRADO +/-.</p> <p>CONTROL 2 (ÁREA DE CONDUCTOR) ESTE MÓDULO MENCIONADO SE COMUNICA POR MEDIO DE INTERFAZ AL CENTRO DE CARGA, CONTANDO CON 9 BOTONES DIGITALES, ON-OFF PULSA ACTIVA -PULSA DESACTIVA, CADA BOTÓN TIENE UN TESTIGO LUMINOSO Y ACÚSTICO. PANTAIA LED QUE MUESTRA LOS TEXTOS DE CADA FUNCIÓN QUE SE REALICEN FUNCIONES: TORRETA, PERIMETRALES, FAROS DE HALÓGENO, ESCENA DERECHA, ESCENA TRASERA, ESCENA IZQUIERDA, INDICADOR PUERTA ABIERTA, VOLTÍMETRO DIGITAL.</p> <p>EXTINTOR. TODO EL CABLEADO ES REALIZADO POR MEDIO DE CONDUCTORES CON CALIBRES PROTEGIDOS CON UN 15% MÁS A LA CARGA QUE TIENEN, CODIFICADOS A BASE DE COLORES, PROTEGIDOS POR MEDIO DE DUCTOS, TUBO FLEXIBLE CALIDAD AUTOMOTRIZ, Y GRUMMETS PASA CABLES. 4 LUCES DE LEDS COLOR CRISTAL EN FAROS Y CALAVERAS.</p> <p><b>EQUIPO MÉDICO CONCEPTO</b></p>				 <p>FERCOM DE PUEBLA S.A. DE C.V. RFC: FPU1510297X4</p>
--	--	--	--	--	--	---



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS GET-OMG-INV-182/2022  
REFERENTE A VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA.

		<p>CAMILLA DESARROLLADA PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES EN LAS SITUACIONES DE RESCATE, AGILIZA LA ATENCIÓN Y PROPORCIONA ESFUERZO DE OPERACIÓN REDUCIDO. RUEDAS CON SISTEMA DE FRENO Y RUEDA DE 127 MM DE DIÁMETRO. RESPALDO AJUSTABLE EN SEIS POSICIONES. CAPACIDAD DE CARGA 300KG ESTRUCTURA DE DURALUMINIO TUBULAR, NO UTILIZAR SOLDADURA, MONTAJE Y FIJACIÓN A TRAVÉS DE ENCAJE, PASADOR ELÁSTICO Y TORNILLO. ASAS LATERALES BASCULANTES CON SISTEMA DE CIERRE AUTOMÁTICO. COLCHONETA REVESTIDA CON MATERIAL IMPERMEABLE, AUTO-EXTINGUIBLE, COSIDO ELECTRÓNICAMENTE. CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA FIJACIÓN DEL PACIENTE CON SISTEMA DE ENGANCHE AUTOMOTRIZ, SIENDO UN CONJUNTO 4 PUNTAS Y 2 CONJUNTOS 2 PUNTAS. SISTEMA DE SEGURIDAD AUTOMÁTICO QUE IMPIDE LA CAÍDA ACCIDENTAL. SISTEMA DE ANCLAJE COMPLETO PARA INSTALACIÓN EN AMBULANCIAS. PRODUCIDA DE ACUERDO CON EL VEHÍCULO A SER INSTALADO. SISTEMA DE RECOGIMIENTO BIARTICULADO, CONJUNTO DE PIERNAS INDEPENDIENTE QUE REDUCE EL ESFUERZO DE ENTRADA Y SALIDA DEL VEHÍCULO. CAPACIDAD DE CARGA: 300KG CAMILLA RÍGIDA CON SU COMPARTIMIENTO.</p> <p>SISTEMA DE INMOVILIZACIÓN PEDIÁTRICA KIT DE 6 COLLARINES INMOVILIZADOR DE CRÁNEO. KIT DE FÉRULAS ADULTO. ARAÑA DE SUJECIÓN: ARAÑA 10 PUNTOS DE SUJECIÓN. FÉRULA MOLDEABLE TABLILLA GRANDE Y CHICA DE 40X10CMYCHIA20X10CM. FÉRULA MOLDEABLE TABLILLA GRANDE Y CHICA DE 40X10CMYCHIA20X10CM. CHALECO DE EXTRACCIÓN. FÉRULA MOLDEABLE DE ROLLO. OXIMETRO DE PULSO (2PIEZAS). ASPIRADOR PORTÁTIL. BAUMANOMETRO ANEROIDE PEDIÁTRICO ADULTO. TORNQUETE ADULTO MARTILLO PARA REFLEJOS: CABEZAL TRIANGULAR PARA UNA MEJOR EVALUACIÓN DE REFLEJOS MANGO CON PLANTA AGUDA PARA REFLEJO PLANTAR. ESTUCHE DE DISECCIÓN. SABANA TÉRMICA. TERMÓMETRO DIGITAL. LÁMPARA DE LED. MOCHILA BOTIQUÍN CANGURO. MOCHILA BOTIQUÍN. MOCHILA MINI PACK MOCHILA PARA TANQUE DE OXIGENO PORTÁTIL. MOCHILA BOTIQUÍN DE PIERNA CHALECO VIAL: CHALECO REFRACTIVO PARA LA TRIPULACIÓN</p>			<p>FERCOM DE PUEBLA S.A. DE C.V. RFC: FPU1510274 / X44</p>	
--	--	---	--	--	--	--



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
 INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS GET-OMG-INV-182/2022  
 REFERENTE A VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA.

		<p><b>BOTIQUÍN MEDICO CONTIENE:</b>  <b>EXTINTOR: UN EXTINTOR PARA FUEGOS ABC</b>  <b>RECOLECTOR DE PUNZOCORTANTE: 1 PL-1 ROJO,</b>  <b>POLIPROPILENO PARA PUNZOCORTANTE CAPACIDAD</b>  <b>VOLUMEN: 1.7LTS. NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-087-</b>  <b>ECOL-1995.</b>  <b>RECOLECTOR DE POLIPROPILENO PARA LÍQUIDOS: 1 PL-1</b>  <b>A AMARILLO, RECOLECTOR DE POLIPROPILENO PARA</b>  <b>LÍQUIDOS VOLUMEN: 1.7ITS. NORMA OFICIAL MEXICANA</b>  <b>NOM-087-ECOI-1995.</b></p> <p><b>MARCA: FIAT</b>  <b>PROCEDENCIA: ITALIA</b></p>				
--	--	---	--	--	--	--


Todos son requisitos esenciales la falta de alguno de ellos será causa de descalificación

Firmada y sellada en todas y cada una de sus hojas, indicando nombre y puesto de la persona autorizada.

**NOTA:** El licitante deberá respetar y llenar el presente formato con toda la información solicitada, ya que en caso de no hacerlo así, será causa de descalificación. Este formato se presentará en **WORD**.

**ATENTAMENTE**  
**PUEBLA, PUEBLA A 15 DE NOVIEMBRE DE 2022**

**LIC. IRVING ARTURO SANCHEZ ENRIQUEZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**



**FERCOM**  
**FERCOM DE PUEBLA S.A. DE C.V.**  
**RFC: FPU151027/X4**